

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ


RESPONSABILE DR SALVATORE BIANCOROSSO

Oggetto: descrizione tecnica cistoscopio

Cisto-uretro-fibroscoPIO-flessibile impermeabile e completamente immergibile in soluzioni, dotato di meccanismo positivo di regolazione angolare della punta, con valore di mobilità dell'estremità distale nelle due direzioni di minimo 210° in un verso e di minimo 140° nel verso opposto. Direzione della visuale pari a 0° e angolo visivo di apertura con valore minimo di 110°. Lunghezza minima operativa pari a 37 cm. Diametro esterno della camicia con valore massimo di 16 charriere. Diametro interno del canale operativo con valore minimo di 7 charriere. Il dispositivo deve essere compatibile (o eventualmente corredato degli opportuni dispositivi di compatibilità purchè siano di semplice utilizzo) con le attuali apparecchiature in dotazione presso la struttura che costituiscono il sistema di video-illuminazione:

VIDEOPROCESSIONE: STORZ, MOD.: TRICOM SL II
DESTINATA/TELECAMERA: DITTO STORZ, MOD.: TELECOM B
FONTE LUMINOSA: DITTO STORZ, MOD.: D-LIGHT C

Cordialità

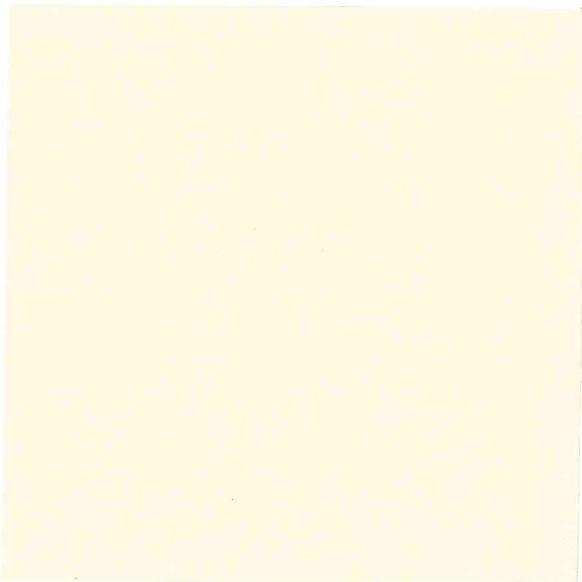

Il Responsabile dell'U.O. di Urologia
Dott. Salvatore Biancorosso

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Resp. F.F. U.O. di Urologia
Dott. Salvatore Biancorosso
Specialista in Urologia
Cod. ENPAM 300200927H
Sigla Prov. AG - Num. iscr. 3438

NB:
+ LUNGHEZZA OPERATIVA
MINIMA 30 CM

37
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Dott. Salvatore Biancorosso
Urologia
Via...
300200927H
Sigla Prov. AG - Num. iscr. 3438